

★ **SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO PE 024/2020**

De: Jenifer Lara

Para: cpl@camaragibe.pe.gov.br

Cópia:

Cópia oculta:

Assunto: SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO PE 024/2020

Enviada em: 25/02/2021 | 08:35

Recebida em: 25/02/2021 | 08:35

image006.png **18.01 KB**

image001.png **671.12 KB**

Bom dia

Venho por meio deste solicitar esclarecimento referente ao pregão eletrônico 024/2020


ORGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMARAGIBE/PE  
PREGÃO ELETRÔNICO N° 024/2020  
DA EMPRESA: COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA  
CNPJ: 95.433.397/0001-11  
TELEFONE: (41) 2102-8344 – JENIFER LARA

Gostaríamos de esclarecer alguns fatos quanto à descrição solicitada para o item.

**Item 35 – Eletrocardiógrafo**

Após análise da descrição presente no edital **não é informado o tipo de papel para impressão do exame de ECG**. Este fator é importante pois, há algumas marcas que **informam que realizam a impressão em 12 canais mas não possuem suporte** para realizar a impressão do exame em papel que demonstrem todas os canais e derivações em uma única página, este sendo um **diferencial a impressão no formato A4**, visto que **agiliza o tempo** do profissional para analisar todas as derivações do devido exame.

**Abaixo imagem ilustrativa de um exame 12 canais no formato A4:**

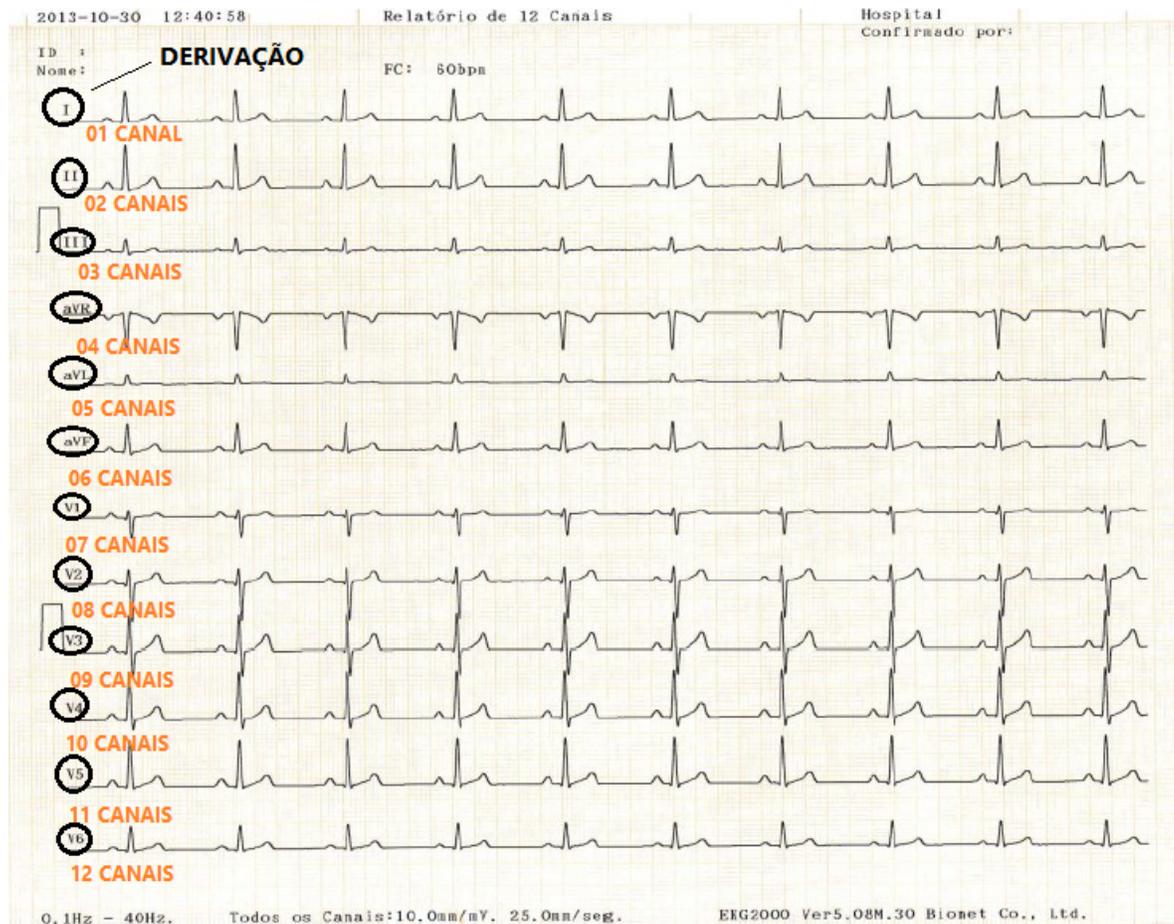

**Sendo assim sugerimos a seguinte especificação:**

Eletrocardiógrafo (ECG) eletrocardiógrafo- canais/operação/comunicação com computador/ computador/conectividade wi-fi/impressão direta no equipamento: 12 canais no formato A4/ direto no console/possui/ não possui computador / sem conectividade wi-fi/12 canais acessório(s): 1 cabo de ECG

**Neste descritivo diversas marcas poderão atender, pois os parâmetros são mínimos, ou seja equipamentos com tecnologia superior poderão ofertar também. E se acatar nossa sugestão não sofrerá alteração de valores aprovados para os itens.**

Diante dos fatos apresentados solicitamos análise técnica para as devidas alterações.

Att.

**Jenifer Lara**

*departamento de licitações*

(41) 2102-8344 | Ramal 8314

